


Programas de vacunas infantiles y para adultos

Programa de vacunas para adultos: waadultvaccines@doh.wa.gov Programa de vacunas infantiles: wachildhoodvaccines@doh.wa.gov | (360) 236-2829

Guía sobre excursión térmica de vacunas

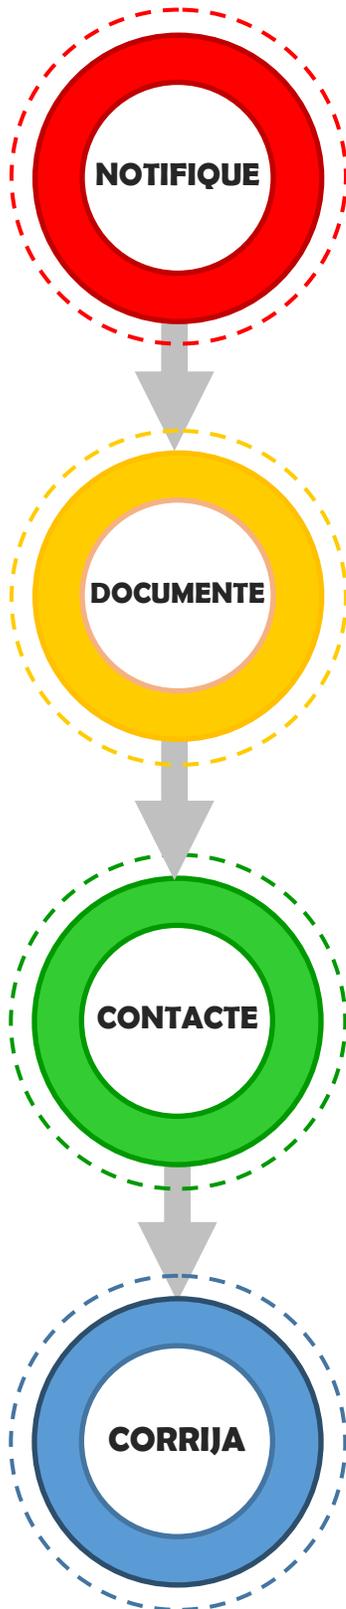

Notifique inmediatamente al coordinador de vacunas principal o suplente si descubre una excursión térmica.

Coloque en una bolsa las vacunas afectadas y etiquételas con una leyenda que diga “NO USAR”. No deseche estas vacunas ni las retire de la unidad de almacenamiento.

Documente los detalles de la excursión térmica, con la siguiente información:

- Fecha, hora y nombre de la persona que completa el informe, descripción del evento, temperatura de la unidad de almacenamiento, inventario de vacunas afectadas
- Cantidad de tiempo que la vacuna ha estado a una temperatura diferente del rango recomendado, lo que incluye excursiones térmicas anteriores

Después de la determinación del fabricante:

- Anote la fecha y la cantidad de tiempo que la vacuna ha estado a una temperatura diferente del rango recomendado en las cajas de las vacunas
- Documente la excursión térmica a través de su portal REDCap, lo que incluirá la determinación del fabricante y los números de caso/archivos PDF o correos electrónicos con la información sobre la estabilidad

Comuníquese con los fabricantes de vacunas.

Esté preparado para proporcionar documentación e información del registrador de datos. Siga las indicaciones del fabricante según la viabilidad de las vacunas. Registre y guarde cualquier número de caso o archivos PDF/emails con la información sobre la estabilidad.

Si las pautas del fabricante no son claras o indican que los proveedores pueden usar su criterio para continuar utilizando la vacuna, debe comunicarse con el Programa de Vacunas Infantiles/para Adultos del DOH (por su sigla en inglés, Departamento de Salud) al correo electrónico WACHildhoodVaccines@doh.wa.gov o WAAAdultVaccines@doh.wa.gov.

Los proveedores no tienen la autoridad para desechar vacunas adquiridas con fondos públicos.

Números de contacto de los fabricantes

(Haga clic en los enlaces para acceder a las herramientas en línea disponibles)

AstraZeneca (Medimmune)	877-633-4411
Bavarian Nordic	844-422-8274
Dynavax Technologies	844-375-4728
GlaxoSmithKline	888-825-5249
Merck	800-672-6372
Moderna	866-663-3762
Novavax	855-239-9174
Pfizer	800-438-1985
Sanofi Pasteur	800-822-2463
Seqirus	855-358-8966

Determine y aborde la causa del problema de temperatura.

- Verifique los aspectos básicos, como el suministro eléctrico, la puerta de la unidad y la configuración del termostato.
- Si la excursión fue el resultado de una fluctuación de temperatura, siga las indicaciones para ajustar la temperatura de la unidad de almacenamiento al rango correcto.
- Si falló el termómetro, utilice su termómetro de respaldo. Si falló la unidad de almacenamiento, aplique su plan de emergencia.
- Si las vacunas fueron trasladadas a otra unidad, proporcione 3 días de temperaturas estables dentro del rango antes de volver a trasladar las vacunas a la unidad.